




+

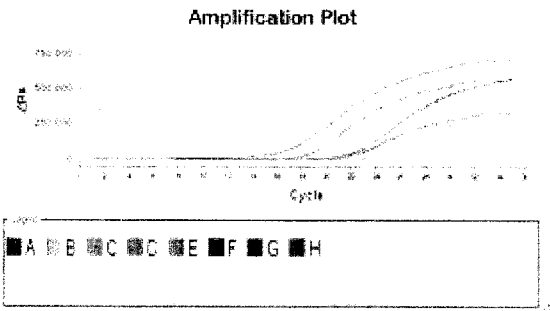


阳性对照

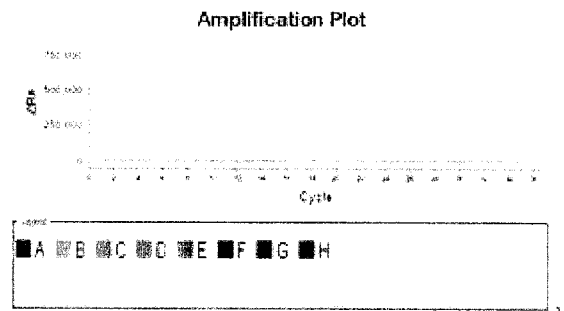

阴性对照

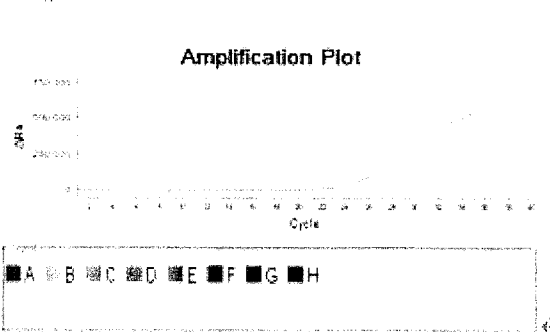

外控

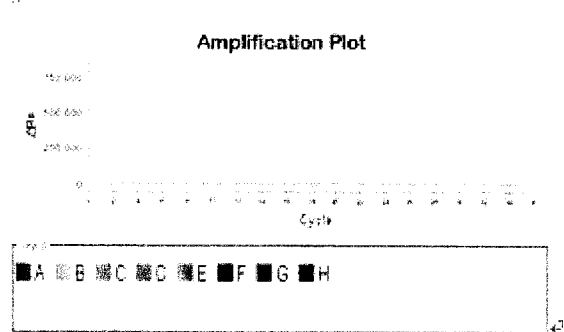

检测样本

检测结果

	18 外显子	19 外显子	20 外显子			21 外显子		
检测项目	G719X	19-del	S768I	20-Ins	T790M	L858R	L861Q	外控
检测样本	阴性	阴性	阴性	阴性	阴性	阴性	阴性	正常
阳性对照	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常
阴性对照	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常

+